

## E53 型感应式电导率分析仪

### 仪器描述

大湖国际 (GLI) 是美国哈希公司的新成员, 自 1970 年以来的 30 多年中一直都致力于供水、污水及工业过程控制在线水质分析提供先进的检测仪表, 1992 年通过 ISO9001 认证。

GLI 生产的 E53 型电导率分析仪结构紧凑、功能完备, 而使用方便, 提供了通常只有在更大型更昂贵的分析仪中才能的功能。



E53 型仪器可以配置来测定电导率和百分浓度。E53 同 3700 系列感应式电导率传感器配合使用。E53 可以测定电导率范围达 2 S/cm, 有 11 条内置的预设好的浓度曲线。带背景灯的大图形液晶屏 (LCD) 显示测定的电导率、过程温度、两个模拟输出以及最多四个继电器接触。菜单屏幕包括多达六个整行的文本以在逻辑上引导用户进行从安装、校准和操作的全过程。仪器功能强大的硬件支持多语言操作。每路隔离的模拟输出都是 0~20 mA 或者 4~20 mA 以及电压可选的。最多提供四个报警/控制连接。E53 分析仪安装在一个表面经粗糙处理的环氧树脂喷涂的固体金属 NEMA 4X 1/2 DIN 外壳中, 适合表盘、表面或者管道安装。E53 也超过了美国和欧洲关于 EMI 和 RFI 的标准。

### 应用领域

广泛地应用于炼油、发电、酿造、制药、化工、水处理、半导体制造等行业。

### 工作原理

3700E 系列感应式电导率传感器的工作原理是: 感应式电导率传感器在溶液中封闭回路中, 产生一个感应电流, 通过测量电流的大小得到溶液的电导率。电导率分析仪驱动初级线圈, 在被测介质中产生一个交变电流, 封闭回路中这一电流信号通过传感器的内径孔和周围的介质。次级线圈产生的感应电流的大小正比于被测介质的电导率。

## 感应式电导率测量系统产品选型指南

3700E 系列感应式电导率  
传感器



MODEL E63



- 增强型多功能菜单操作
- 电导率，百分比浓度或者 TDS
- 内置/用户定义的浓度表
- 事件日志簿（100 条事件）

- 简单的交互式诊断功能
- 两个隔离的 4-20mA 输出
- 三个报警/控制继电器

MODEL E53



- 多功能菜单操作
- 电导率，百分比浓度或者 TDS
- 内置/用户定义的浓度表
- 多语言支持能力

- 两个隔离的 4-20mA 输出
- 四个报警/控制继电器
- 简单的交互式诊断功能
- 1/2 DIN 通用安装外壳

MODEL E33



- 简单功能菜单操作
- 电导率，百分比浓度或者 TDS
- 多语言支持能力
- 两个隔离的 4-20mA 输出

- 两个报警/控制继电器
- 简单的交互式诊断功能
- 1/4 DIN 面板安装外壳

MODEL 692E



- 两线制本安（带隔离栅）
- 电导率，百分比浓度或者 TDS
- 内置/用户定义的浓度表
- 两个隔离的 4-20mA 输出

- 16~36 VDC 供电
- NEMA 4X 表面安装外壳

MODEL PRO-E3



- 两、三或四线制连接
- 简单功能菜单操作
- 多语言支持功能

- 两个隔离的 4-20mA 输出
- 12-30 VDC 直流电
- 管道、墙上或者一体化传感器安装
- 内置/用户定义的浓度表

连接电缆 1W0980 两线，4~20 mA

SCADA, PLC  
记录仪等

## 仪器接线图

### 1. 电气连接图




序列号前缀为“B”的分析仪的接线图



序列号中无前缀的分析仪的接线图

## 2. 传感器接线图

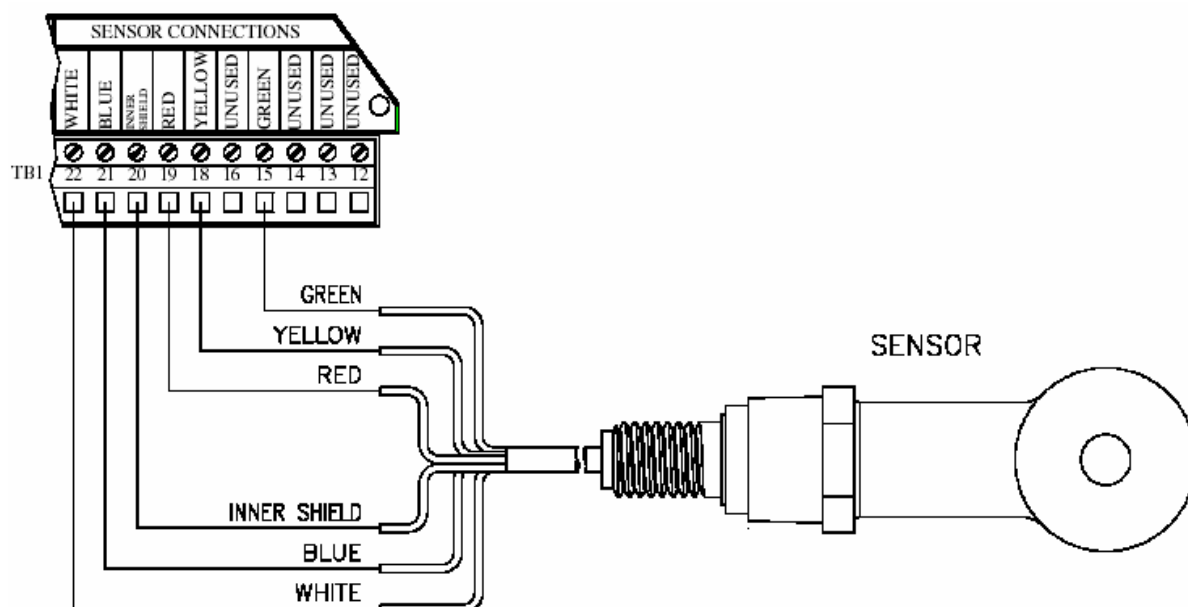

将 GLI 感应式电导率传感器连接到序列号中前缀为“B”的分析仪



将 GLI 感应式电导率传感器连接到序列号中无前缀的分析仪

### 3. 电源接线图



150V 单相电源与序列号前缀为“B”  
的分析仪的连接图



230V 单相电源与序列号前缀为“B”  
的分析仪的连接图



230V 分相电源与序列号前缀为“B”  
的分析仪的连接图



115V 单相电源与序列号中无前缀的  
分析仪的连接图



230V 单相电源与序列号中无前缀的  
分析仪的连接图



115V 分相电源与序列号中无前缀的  
分析仪的连接图

## 仪器安装图

### 1. 安装方法

#### (1) 室内安装



#### (2)

现场安装提供三种选择：

- (1) 墙上安装
- (2) 水平管道安装
- (3) 垂直管道安装



墙上安装



水平管道安装

垂直管道安装

## 2. 安装尺寸



注：图中标注的数值单位为英寸，括号中的单位为 mm。

## 仪器技术指标

### 1. 操作性能

**显示：** 图形点阵液晶显示屏 (LCD)，分辨率为  $128 \times 64$  像素，带发光二极管 (LED) 背景灯。主要字符显示高度为  $1/2$  英寸 (13 mm)，辅助信息字符显示高度为  $1/8$  英寸 (3 mm)，菜单界面包括最多 6 整行的对话文本。

**测量范围：**

**电导率**                       $\mu\text{S/cm}$  : 0~200.0 或者 0~2000  
                                     $\text{mS/cm}$  : 0~2.000 , 0~20.00 , 0~200.0 或 0~2000  
                                     $\text{S/cm}$  : 0~2.000

**百分浓度**                      0~99.99% 或者 0~200.0%

**TDS**                            0~9999 ppm

**温度**                             $-20.0 \sim +200.0$  或  $-4.0 \sim 392.0$

**模拟输出 (1 和 2)**            0.00~20.00 mA 或 4.00~20.00 mA

**环境条件：**    **操作：**             $-4 \sim +140$     ( $-20 \sim +60$  ) , 相对湿度 0 ~ 95% , 没有冷凝  
                    **存放：**             $-22 \sim +158$     ( $-30 \sim +70$  ) , 相对湿度 0 ~ 95% , 没有冷凝

**继电器：**

**类型/输出：**                      两个或四个机电继电器，SPDT (C 型)，UL 级 5A、115/230 VAC，5A @ 30 VDC 电阻

**操作模式：**                      每个继电器 (A, B 和 C) 都能够选择来通过所选择的主参数 (电导率、百分浓度或者 TDS) 或温度值来进行驱动。

**功能模式：** **控制**                      可以设置成：高/低相位调整、定点设定、死区、过载计时、开延迟和关延迟。

**报警**                                  可以设置成：低位报警点、低位报警点死区、高位报警点、高位报警点死区、开延迟和关延迟。

**状态**                                  不可配置，仅当“错误”诊断报警条件成立时会触发 (传感器膜穿孔、废电解液以及其它的传感器和仪器错误条件)

**定时**                                  由用户设定时间间隔和长度来控制某个基于时间的设备。

**指示器**                              继电器 A、B、C 和 D 的指示器分别指示各自的中继状态。

**温度补偿**                              选择了 Pt 1000 RTD 温度元件就能自动在  $14.0 \sim +392.0$  ( $-10.0 \sim +200.0$  ) 范围内进行温度补偿，或者用户手动地

输入一个用户自设的温度来进行补偿。

**注意：**所选择的测定值（电导率、百分浓度或者 TDS）决定了下面哪一种温度补偿方法将被采用：线性每 的%斜率、内置的天然水性质表、用户定义的温度表，或者是不进行补偿。

**传感器到仪器的距离：** 电缆的最长长度是测量范围和允许的非线性的的一个函数。推荐使用下面的值：

| 满量程                                    | 最大长度            |
|----------------------------------------|-----------------|
| 200~2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$       | 200 英尺 ( 61 m ) |
| 2000~2,000,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 300 英尺 ( 91 m ) |

**注意：**当测定的是百分比浓度时，需要将分析仪的满量程转换为电导率来确定最长的距离。

**电源要求：** 90~130 VAC , 50/60 Hz 交流电（最大 10 VA）；或者 180~260 VAC , 50/60 Hz 交流电（最大 10 VA）

**校准方法：**

**1 点校准（浓度或者 TDS）**

输入一个参考溶液或者是样品值（由实验室分析得到）。

**清零**

当传感器在空气中时，按键来启动自动系统清零。

**模拟输出：** 隔离的 0/4 ~ 20 mA，每个都具有 0.004 mA（12 位）分辨率，能够最大驱动 600 $\Omega$  的负载。

\* 每一个模拟输出端可以指定所选定的主要测定值（电导率、百分浓度或者 TDS），或者是测得的温度值。用户可以输入参数值来指定所需要的最小和最大输出 mA 值。在校准过程中，两个输出均可选择来跟踪测定，保持它们的当前值，或者是传输给预设值并根据这些值来操纵相关的元件，或者是保持活动状态以对测定值作出响应。

**通讯：** RS-232 能够使用 IBM 兼容个人计算机和 GLI 可选的软件工具包实现分析仪测定数据的配置与调用。

HART 协议 能够使用合适的手持终端或者数据系统通过 HART 软件建立的通讯链接实现多台分析仪的测定值的配置和调用。

**存储备份（断电不丢失）：**

所有的用户设置保存在电可擦除只读存储器(EEPROM)中。

**电磁抗干扰（EMI/RFI）特性：**

在抗干扰特性上超过美国标准，达到欧洲标准；发射特性也符合规定要求。

## 电气认证：

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 欧洲委员会 EMC                              | 符合 CE 认证 , 传导和辐射发射特性对应于 EN 50081-2 , 抗干扰特性对应于 EN 61000-6-2 |
| 一般目的                                   | CSA/CSA <sub>NRTL</sub> 和 FM ( UL 待确定 )                    |
| Class I , Division 2<br>( Groups A~D ) | CSA/CSA <sub>NRTL</sub> 和 FM ( UL 待确定 )                    |

## 2 . 仪器测定性能 ( 电气、模拟输出 )

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 准确度  | 满量程的 0.5%               |
| 稳定性  | 每 24h 为满量程的 0.2% , 不会累积 |
| 重复性  | 满量程的 0.1% , 甚至更好        |
| 温度漂移 | 零点和满量程：每 满量程的 0.02%*    |

\* 这些典型的性能指标为：

- 1 . 基于 25 , 电导率为 500 $\mu$ S/cm 甚至更高。如果用户应用的电导率小于 500 $\mu$ S/cm , 请咨询 GLI。
- 2 . 在温度高于 100 直至最高可显示温度 200 指标会降低 , 详情请咨询 GLI。

## 3 . 机械性能

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外壳   | NEMA 4X 材料 , 聚碳酸酯面板 , 环氧树脂喷涂 , 优质抛光铝门和箱体 , 带有 4 个 1/2 英寸 ( 13 mm ) 的导流孔 , 尼龙安装托架 , 不锈钢硬件 |
| 安装形式 | 面板、表面以及管道 ( 水平和垂直 ) 安装                                                                   |
| 净重   | 约 3.5 磅 ( 1.6 kg )                                                                       |

## 产品选型

|                                                                                           |  |                                        |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---|--------|
| <b>型号</b><br>E53 感应式电导率分析仪 ( 也可测定百分比浓度或者 TDS ), 安放在 1/2 DIN、NEMA 4X 外壳中, 带有面板、表面或者管道安装硬件。 |  |                                        |   |        |
|                                                                                           |  | <b>继电器</b><br>A2 两个机电继电器<br>A4 四个机电继电器 |   |        |
|                                                                                           |  | <b>通讯输出</b><br>A 无<br>B HART 协议        |   |        |
|                                                                                           |  | <b>保留目录号</b>                           |   |        |
|                                                                                           |  | <b>设备标签</b><br>N 无<br>P 纸<br>S 不锈钢     |   |        |
| E53                                                                                       |  |                                        | 1 | 产品订购号码 |

请每项各选择一个选项。

## 附件 ( 另外订购 )

- 3700E 系列无电极电导率传感器：参考 3700 系列传感器资料
- 软件工具包 1000G3311：这个工具包用于 IBM 兼容个人计算机。软件可以创建和下载多套分析仪的配置值。工具包包括 GLI 软件 CD-ROM 和十英尺电缆，终端为 RS-232 接口和剥皮/镀锡导线，用于与分析仪之间的连接。
- 遮阳罩 1000G3088-001：铝制的罩子，为防止阳光直射所引起的额外影响提供保护。



## 北京安恒测试技术有限公司

北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北楼12层

邮政编码：100044

电话：010-88018877

传真：010-88018288

上海市天目中路428号凯旋大厦

邮政编码：200070

电话：021-63176770

传真：021-63177618

[HTTP://WWW.watertest.com.cn](http://WWW.watertest.com.cn)